

ERGOSportive™



OWNER'S MANUAL
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



Actual product appearance and functionality may vary from photographs, illustrations and descriptions included in this manual.
L'apparence et les fonctionnalités du produit peuvent différer de la photo, des illustrations et des descriptions incluent dans ce manuel.

Safety Precautions and Usage Statements

Attention: Important Safety Disclaimers

Read all instructions before using your adjustable base. Save these instructions.

TO REDUCE THE RISK OF SHOCK, BURNS, FIRE OR INJURY:

For optimal safety and operation, plug bed base into a surge protector (not included). The bed base should only be plugged directly into a wall outlet or surge protector (strongly recommended). Always unplug the base from the electrical outlet before servicing any part of the base. To reduce risk of electric shock, unplug the base before cleaning. To safely disconnect, ensure the base is in a flat position with all motors off, and unplug from power source. Keep the power cord away from heated surfaces. Never operate the base when the air openings are blocked. Keep air openings free of lint, hair and the like. Do not drop or insert any object into any opening. Discontinue use of the bed base and contact a qualified service center if: it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or it has been dropped into water. Only use this bed base for its intended use as described in this manual. Do not use accessories/attachments that are not recommended by the manufacturer. Close supervision is required when the bed base is used by or near children, convalescents, disabled persons or pets. Improper connection of the equipment can result in the risk of electrical shock, electrical fire or faulty operation of this bed base. If the plug does not fit your outlet, contact a qualified electrician to install a suitable outlet. Unauthorized modification or failure to use a wall outlet or surge protector could void the electrical portion of your warranty.

PETS AND CHILDREN:

Immediately dispose of all packing materials as it may pose a smothering risk to small children and pets. To avoid injury, it is not advised to allow children and small pets to play on or under the bed. Children should not operate the bed base without adult supervision.

PACEMAKERS:

Some products contain Neodymium MAGNETS which may interfere with devices such as pacemakers, ICD's and any other device sensitive to magnetic fields. It is STRONGLY recommended that owners of such medical devices consult their physician prior to using products that contain Neodymium MAGNETS. It is also possible that some pacemakers may falsely interpret the optional massage feature vibrations as movement/exercise. This is a common occurrence with any product that create a vibrating movement and may affect the pacemaker. Please consult your physician before using the massage feature.

IN-HOME USE AND HOSPITAL STANDARDS:

Ergomotion adjustable bed bases are designed solely for in-home use. This base was not designed as a hospital bed and is not designed to meet hospital standards. Do not use this base with TENT TYPE oxygen therapy equipment or near explosive gases.

ADDITIONAL SAFETY FEATURES

Casters (optional leg accessory) are equipped with locking wheels to prevent unwanted movement. Even when locked and unable to roll, it is possible for the casters to slide. Free release head and foot motors are designed to lower the mattress by retracting only with gravity, never pulling downwards, which minimizes pinch points.

Manual operation – If something gets caught in the platform when flattened, you can manually raise the platform up by lifting at either the head or foot to relieve pressure and allow for release.

Emergency stop – Stop the motion of the platform by pressing any button on the remote control.

Power outage – Use the “Emergency Battery Backup Strap” as a temporary power source to get the base to a desired position. Instructions on how to operate the Battery Backup Strap are on the Emergency Battery Backup page(s).

Safety Precautions and Usage Statements

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal. During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This contact may result in metal on metal or metal on plastic contact. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position. In normal base operation, the wheels, which allow the bed to maintain its distance from the wall, will make contact with the steel platform supports of the base creating a contact noise. When entering, exiting or shifting weight on the base, this contact noise may be audible as the wheels make contact. This is normal.

MATERIALS


Ergomotion adjustable bases are constructed from various materials including woods, metals, plastics and fabrics. Tension, pressure or movement applied to the frame, platform or shroud through general use may create an audible sound.

MESSAGE OPERATION AND LOCATION ENVIRONMENT

The massage feature will emit a tone during operation. This is normal. As the massage intensity level is increased, the tone will intensify. The volume of this tone is directly related to the location environment. For example, when demonstrated in a show room, the surrounding environmental noise will cover some of the massage noise. However, when installed in a home setting with wooden floors, carpeted or not, the massage volume will be more noticeable. To minimize this resonance, place a piece of carpet, or rubber caster cups, under each leg or caster of the base. It is possible to experience vibration or noise from the exterior bed frame, headboard brackets, headboards or footboards if

mounting bolts are not firmly tightened.

Levels 1-2 of massage intensity represent the revolutions of the motor per minute. Level 2 provides the maximum number of RPMs. However, this does not mean that the feeling of vibration is the strongest. Depending on the mattress material, thickness, and positioning of the user, the feeling of vibrations will differ. We encourage the user to find the massage intensity setting that suits them best. It is important to understand the physics of vibrations. Just as an engine may run rough during idle, as the RPMs increase, the vibrations change concurrently.

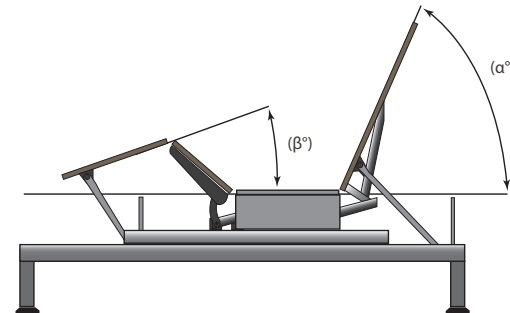

TOLERANCE

All Ergomotion adjustable foundations, depending on make and model, are designed and manufactured to perform and function within designated quality control parameters. Bases are subject to meticulous and rigorous inspections during the quality control process to ensure bases will operate within these standards during normal operating use. Normal operating use is defined as the following: Adjustable foundation is to be operated with a mattress and load. Testing procedures require lifetime cycle tests with up to 120kg distributed load. The angle (designated " α " in figure 1) between the back section and the flat section

Safety Precautions and Usage Statements

for various configurations of the mattress support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to $1\frac{1}{2}''$.

The angle (designated “ β ” in figure 1) between the flat section and foot section for various configurations of the mattress support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to $\frac{3}{4}''$.

Any adjustable foundation deemed to be within these allocated tolerances is considered to have met the manufacturer’s quality control standards.

THAT “NEW PRODUCT” SMELL:

Some people notice a slight odor to their new adjustable base—this can come from our material manufacturing process. This smell is normal and usually disappears before the product reaches you. Sometimes, however, this smell may still be noticeable. It usually disappears after a few weeks, providing adequate ventilation of the product and the environment.

BREAK IN PERIOD:

You can speed up the break-in period by simply spending time in the adjustable bed through activities such as reading, watching TV or playing with the kids or grandkids. The extra movement will help the adjustable base respond to weight and temperature changes. Some of the materials in our adjustable bases such as the woods, metals and plastics used in the platform, frame and components are sensitive to moisture content and temperature and may make sounds in colder environments.

PAIRED OPERATION:

When operating a “paired” split base setup there may be a time latency up to 1.5 seconds between each bases articulation.

WEAR AND TEAR:

Wear and tear is damage that naturally and inevitably occurs as a result of normal use or aging.

FABRIC CARE:

To prolong the life of your fabric, protect from direct sunlight whenever possible. For spot cleaning, wipe area with a light damp sponge or vacuum with a soft brush attachment to remove particles. Keep at a minimum of 30cm (12 inches) away from direct heat sources. For a deeper cleaning, blot liquid spills with a clean dry cloth. Wipe with a clean cloth dampened with warm water. Do not wet excessively. A soft bristle brush may be used to remove ingrained soil. Avoid scratching by gentle brushing. Wipe with a clean cloth dampened with warm water to remove residues. Dry in shade away from direct heat. If persistent marks remain visible after cleaning, seek professional advice.

PRODUCT RATINGS:

The lift motors are not designed to operate continuously for more than [2] minutes in an [18] minute time period or approximately 10% duty cycle. Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty. The massage motors are not designed to operate continuously for more than 30 minutes at a time. Please allow the massaging system to rest for 30 minutes after automatic massage shut off before restarting.

WEIGHT LIMITS:

This product is not rated to support weights in excess of 750 pounds / 340 kg inclusive of the mattress and bedding. The base will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the bed base. The adjustable base is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.

Safety Precautions and Usage Statements

IMPORTANT DO'S AND DON'TS

DO:

- Plug your adjustable base into a power surge protector.
- Evenly distribute weight when sleeping in a split setup. Uneven distribution of weight can cause the base to raise unevenly.
- Call Customer Service for any technical issues. Do not try to force the base down, this can damage the motors or frame.
- Use mild soap and water to clean your adjustable base if staining occurs.
- Keep in mind that adjustable bases are recommended to be used with adjustable friendly mattresses.
- Lower to the flat (horizontal) position after use and in between presets.
- Register your warranty as soon as your adjustable base has been delivered.

DON'T:

- Sit on corners/edges of base, this may warp the frame, struts or foam.
- Tilt the base on its side. This can damage the legs and/or leg screws.
- Stand or jump on the adjustable base at any time, this can damage the frame and motors.
- Drag the base to move it. Dragging the base could damage the frame, strip the nut/bolts or break the legs. Purchase castors if you plan on moving your base routinely.
- Enter and exit the adjustable base with the head and/or foot in the articulated position. You must always enter or exit your adjustable in the flat (horizontal) position.
- Tinker with or modify base. This will void the warranty.

- Press down on the head or foot while actuated can damage frame and motors.
- Do not use mattresses that contain more than 5cm of latex.

FCC Compliance:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Parts List

Before discarding the packing materials, ensure all the parts are accounted for.

All electronics and components that need to be installed are located in boxes under the base or attached to the frame.












- A) Wireless Remote Control x1 and AAA Batteries x3
- B) Legs x6
- C) Mattress Retainer Bar* x2
- D) Power Cord
- E) Power Supply
- F) Battery Backup Strap
(9 volt alkaline batteries not included)
- G) SmartSync® Cord‡
- H) Connecting Strap‡*
- I) C Clamps x2
- J) Long Bolts x4, Washers x8, Nuts x4
- K) 13 MM Outer Hexagonal Wrench x1,
5 MM Hex wrench x1



Misc Parts (not included):

- L) Surge Protector
- M) 9 Volt Alkaline Batteries x2



* These items are attached to the base for shipping purposes. Carefully remove from base and set aside.

‡ Only included in Twin Long and Split King bases.

A) 	B) 	C)* 
D) 	E) 	F) 
G) ‡ 	H) ‡* 	
I) 	J) 	K) 

MISC Parts (NOT INCLUDED)	
L) 	M) 

Base and Remote Overview

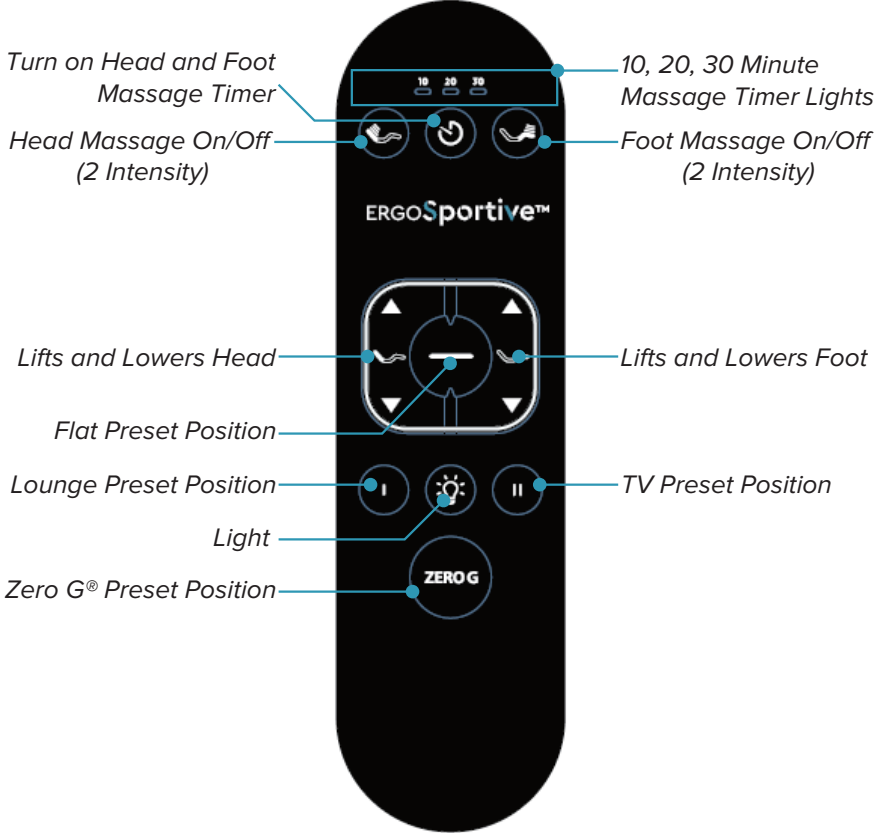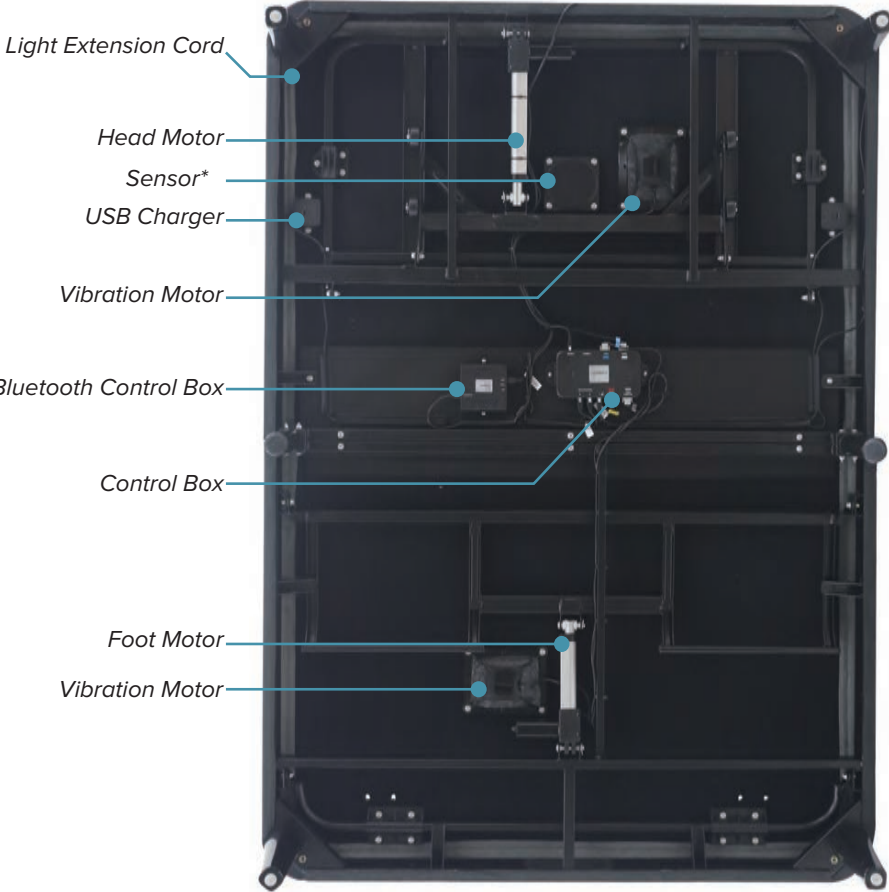


*Note: Queen bed includes two sensors.

Quick Reference Guide

Not to scale. For illustration purposes only. Read all instructions before beginning installation.

ELECTRONICS OVERVIEW

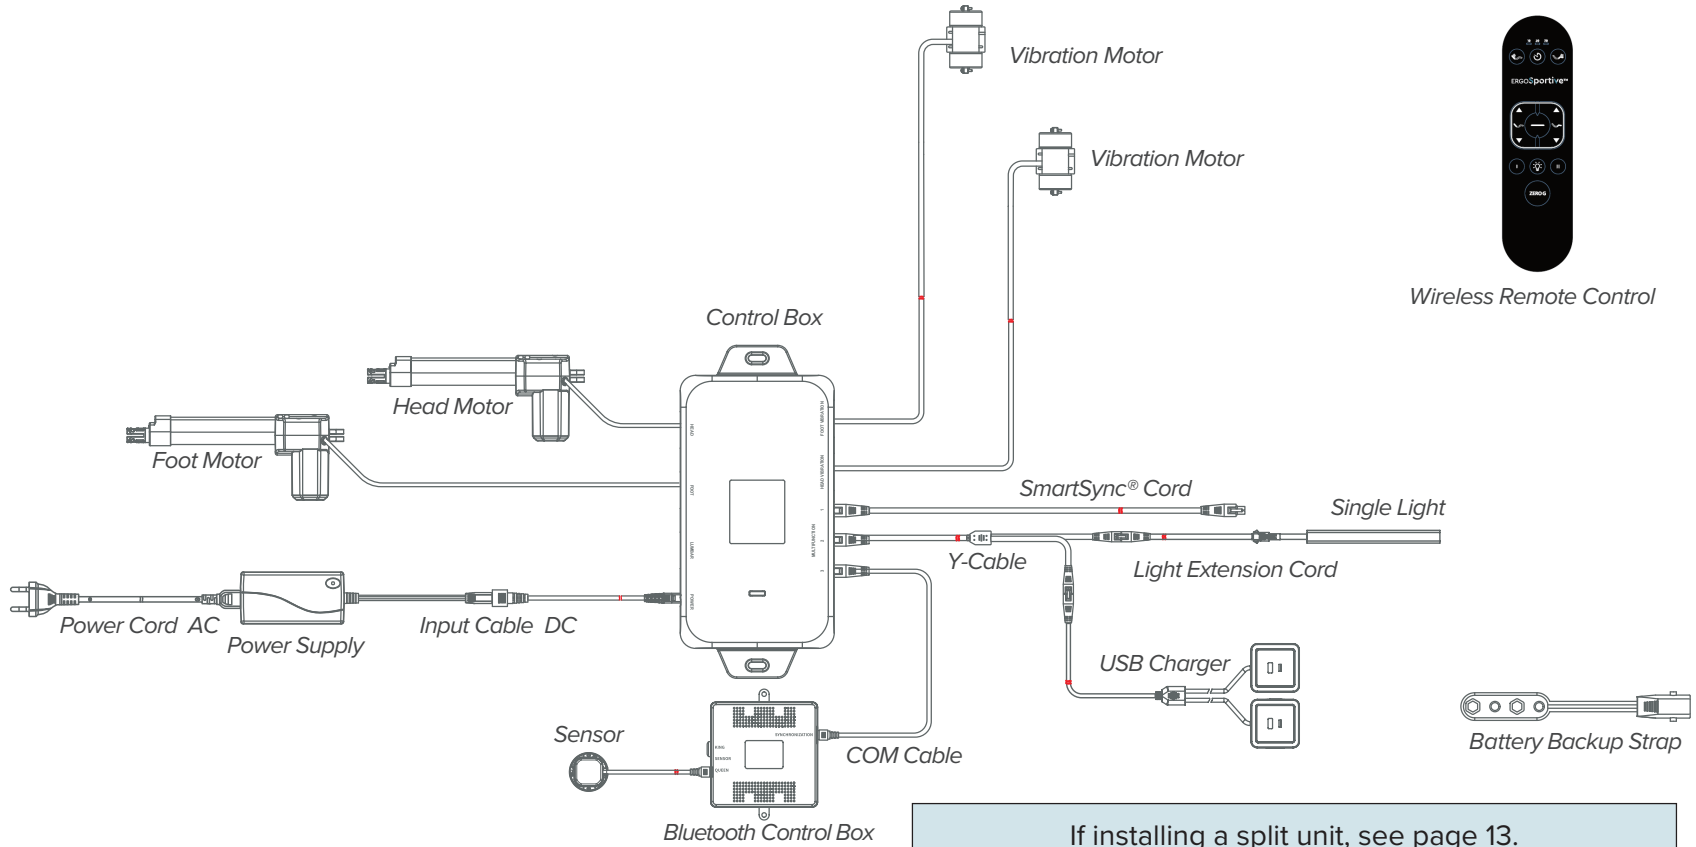


Installation Guide

Always use two people when setting up the base.

STEP 1

Remove the bed from box, and keeping the bottom-side facing up.

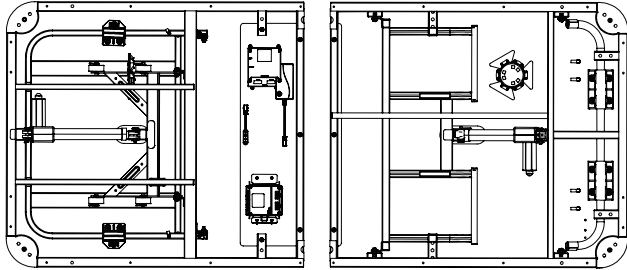

STEP 2

Connect the frames together, slide C-clamp over the frame connections (Refer to Fig B) in the middle of both sides of the base.

Fig A





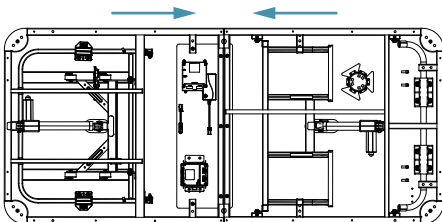


Fig B

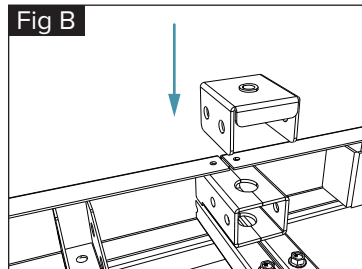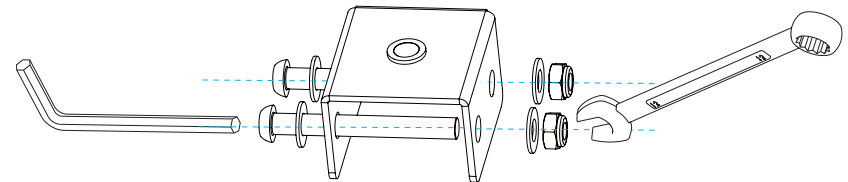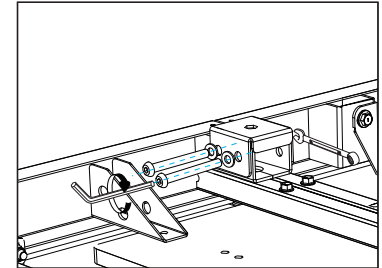

STEP 3

Insert two long bolts through a washer before inserting them through the holes on the side of the C-Clamp. Using inner hexagon wrench.

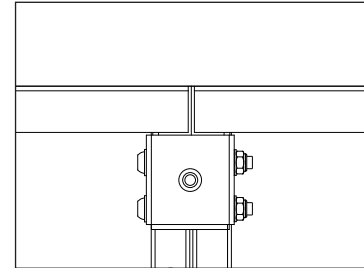

STEP 4 (Optional)

To install the legs, thread the washer over the bolt of the leg with the recessed side facing the leg. Insert each of the four tapered legs on each corner of the frame using the bolt hole nearest the long edge of the bed. Insert each of the two cylindrical (round) legs on the frame in the center edge of bed. Tighten the legs to the base by hand. **Do not over tighten.**

Note: If you are installing the ErgoSportive on an existing platform or bed frame with slats, it is not necessary to install the legs.

Installation Guide

STEP 5

To sync two bases see detailed installation instructions on page 13.

Locate the Battery Backup Strap and set it aside. Be sure that it is accessible after the base is set up.

STEP 6

Uncoil the input Power Cord (connected to Control Box's power port) and plug into Power Supply.



STEP 7

Uncoil the Power Cord and connect to the Power Supply. Place Power Supply on the ground and extend from the base. Ensure that the Power Supply and all attached cords are directed toward the desired surge protector.



STEP 8

Carefully flip the base over.

Important: Two people are required to move the bed base. Do not drag across the floor. Do not rest frame on its side, excessive pressure may damage the legs (if used).

STEP 9

Plug the power cord into a power source.

A surge protector is recommended.

STEP 10

The remote need be operated within 10 seconds of powering on the bed to ensure successful pairing. Quickly test remote functions to verify proper setup before placing mattress on base. Return the base to a flat position before placing the mattress on top.

STEP 11


Install mattress retainer bars by inserting both ends of the mattress retainer bar into the holes on the platform and laying the bars down with curved side facing up.



Setup is now complete! Test all functions on remote.

Remote Control

Remote Control arrives paired to the adjustable base.
Three (3) AAA batteries are required to operate the remote.

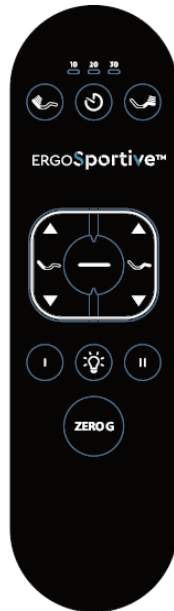





TO PROGRAM THE PRESET POSITIONS:

Articulate the head and foot to your desired position. Next, press and hold one of the preset buttons [I, II] for 5 seconds. The position is now saved.

NOTE: To restore the preset buttons back to their original factory settings, hold **FLAT** and **ZERO G** simultaneously for at least 5 seconds. The original presets will be restored.






MESSAGE FEATURE

-  The HEAD button will turn on the head massage. Cycle through 2 massage intensities.
-  The FOOT button will turn on the foot massage. Cycle through 2 massage intensities.
-  Message timer. Adjust the massage timing for 10 mins, 20 mins, or 30 mins.
-  The light on the top of the remote indicates a 10, 20 or 30 minute timer setting. Massage will automatically shut off after 10 minutes if the massage timer isn't set.

ADJUST

-  The HEAD ▲ ▼ arrows lift and lower the head section of the base.
-  The FOOT ▲ ▼ arrows lift and lower the foot section of the base.

ONE TOUCH BUTTONS

-  One touch Zero G® preset position. Zero G® adjusts your legs to a higher level than your heart helping to improve and promote circulation.
-  One touch FLAT preset position.
-  One touch lounge preset position.
-  One touch TV preset position.
-  Long press 5 seconds to adjust brightness.


Remote Control Pairing

Remote Pairing

The original remote that comes in the box is already paired to the adjustable base. No further action is required. In the event that the remote is not paired with the base, follow the steps below.

STEP 1

Unplug the Power Cord from your power outlet. Wait 1 minute, then plug it back in to your power outlet. Perform Step 2 within 10 seconds, while the control box light is illuminating.

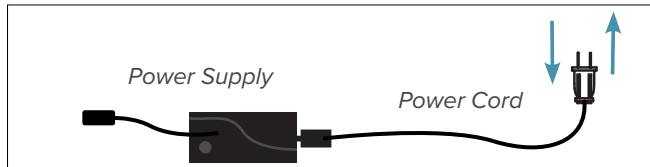

STEP 3

The remote is now paired to the adjustable base. Test all remote functions. If the remote buttons do not impact the adjustable base movements, please repeat the process again.

STEP 2

Press and hold the PAIR button on the back of the remote. The PAIR button will illuminate and start to flash. When the PAIR button stops flashing, the Pair LED light on the control box will stop flashing. Release the PAIR button.



Battery Backup Strap

For emergency use only, in case of a power outage.

Batteries are not to be used for normal operation of the bed.

STEP 1

Disconnect the Power Supply from the input power cord.


STEP 2

Connect the Battery Backup Strap to the (2) Alkaline 9 Volt batteries. Do not mix brand name batteries.



STEP 3

Connect the end of the Battery Backup Strap to the input power cord that is attached to the control box.

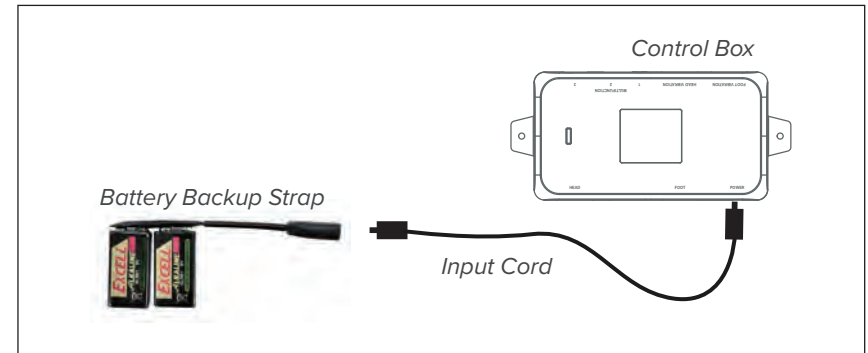

STEP 4

Use the remote to return the base to a flat position.

Note: Detach the Battery Backup Strap and reconnect the power supply after the emergency is over, as the system will continue to draw power from the batteries even if not in use.

Syncing Two Bases (Optional)

A SmartSync® Cord is included with the base. Only available on select models.

The SmartSync® Cord connects the two control boxes to a single remote for the synchronization of two bases. Please connect the synchronization cable before installing the headboard.

STEP 1

Unplug bases from power source.

STEP 2

Connect the SmartSync® Cord to the Multifunction port of each Control Box.


STEP 3

Plug bases back into the power source.

STEP 4

Check to ensure all cords are securely attached. Both remotes will now operate both bases simultaneously.

The system is now linked. Pressed buttons on either remote will control the two bases simultaneously.

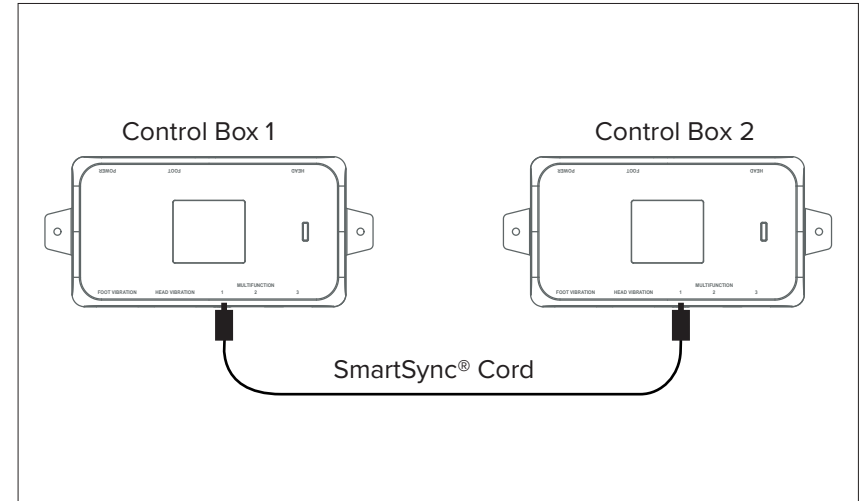

PERFORMANCE NOTES

If bases become mismatched, returning the bases to the flat positions will re-sync the mechanical positions.

Controlling LED Light Separately



This page is intended to explain how to enable both remotes to control the light strip when the sync cord is unplugged. Only applied on Split King bed.

STEP 1

Unplug the synchronization cable of bed A and bed B.

STEP 2

Press and hold the flat button of both A and B remote until the A and B remotes' lights are flashing, the light will stop flashing when the pairing is complete.

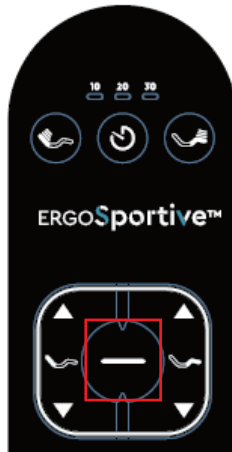

STEP 3

If the remote lights are flashing for a long time, it means the pairing has failed, wait 20 seconds for the light to stop flashing. Then repeat step 2.


Connecting Strap (Optional)

**Connecting straps are secured to the base frame upon delivery.
Legs are required for the installation of the connecting straps.**

STEP 1

*Legs are required for the installation of the headboard brackets.
To purchase legs, please contact **Customer Service:**
support@ergosportive.com*

With the bases in their desired location, slightly loosen both legs to allow the strap to fit on the leg bolt, between the leg washer and frame.

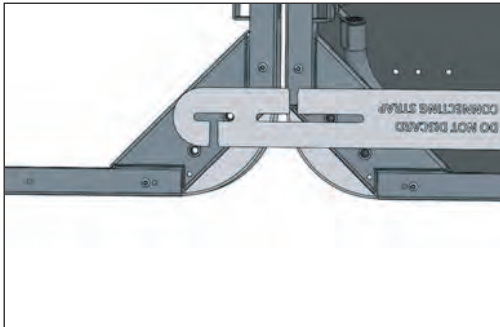

STEP 2

Slide side (a) of the connecting strap onto leg bolt. Swing the strap and connect side (b) to the opposite leg bolt. Secure the strap by shifting to the left.








STEP 3

Re-tighten legs. Do not over tighten. Use the remaining strap and repeat on other end of the base.

Headboard Installation Guide

Parts List:

All the following spare parts are not included in the bed, they are packaged with headboard. It can also be sold as an accessory if required.



A) 	B) 	C) 
Headboard Bracket X2	Headboard Spigot X2	Hexagon Screw X6
D) * 	E) 	
5 MM Hex Wrench X1	Headboard Bracket X2	

* The 5 MM hex wrench is included in the head bracket fitting package.

Note that part B is for TXL and Queen sizes. Part E is for King size.

STEP 1


Use two hexagon screws to attach the head bracket female buckle on the bed frame.

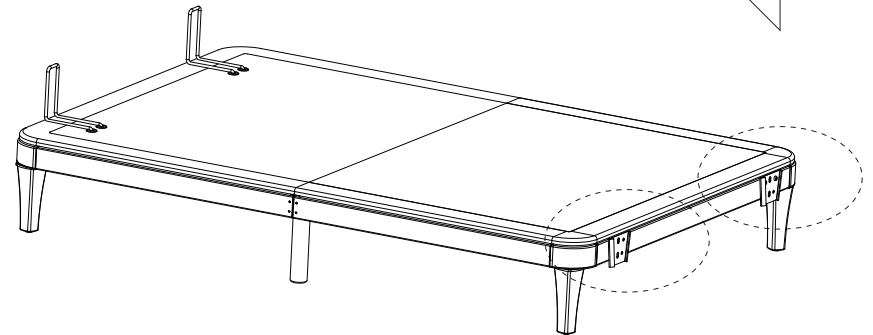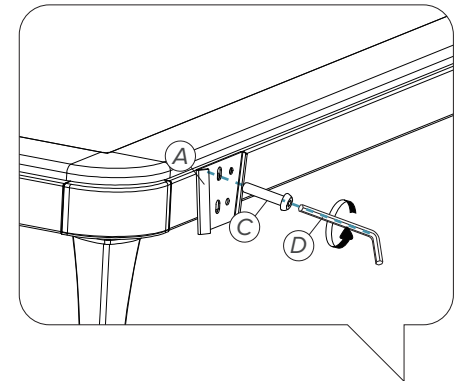


Headboard Installation Guide

STEP 2 (For King headboard only)

Remove four hexagon screws from the pre-install headboard spigots.

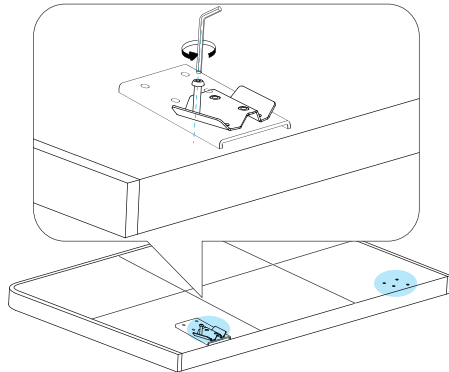


Reattach bracket to headboard using the four uppermost holes with screws removed in previous step. Fasten securely.

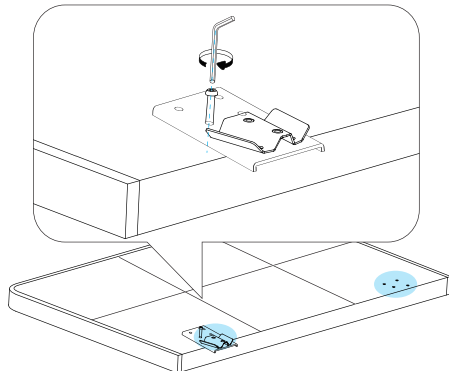

STEP 3


It takes two people to lift the headboard align the male buckle of the headboard with the female buckle and insert it vertically.

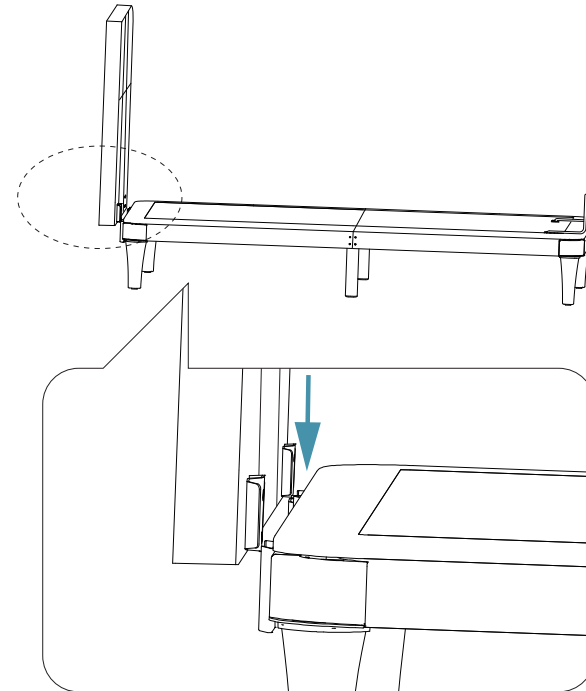

Headboard Installation Guide


STEP 4

Power on the bed and raise the head. Insert a hexagon screw and tighten to firmly attach the headboard to the bed base. Note that it may be necessary to slightly lift the headboard to align the screw.

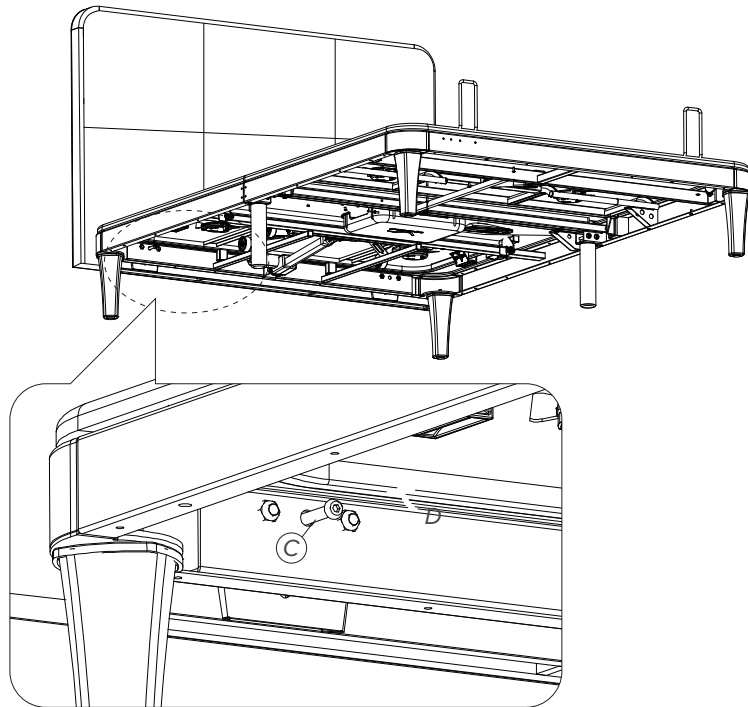

STEP 5

Disconnect power to the bed. Connect the LED light. Reconnect power to the bed.

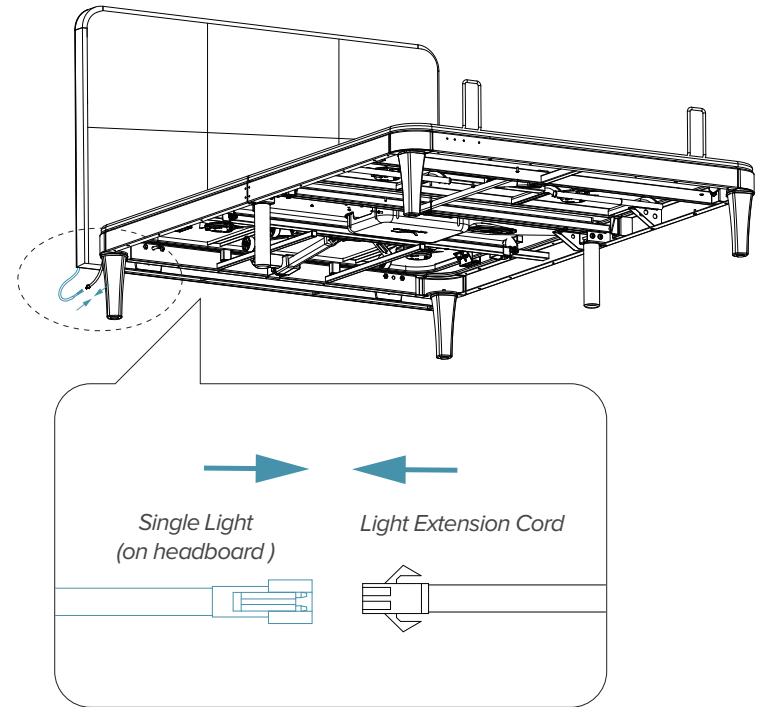

Assembling Video



Please scan the QR code for the Assembling video

ErgoSportive™ APP

STEP 1 DOWNLOAD APP

Download ErgoSportive™ App.

Download Android Version of the APP from the Google Play.

Download iOS version of the App from the Apple Store.



STEP 2 REGISTRATION

Open the ErgoSportive™ APP, click on the **"Sign Up"** button on the sign in page and follow the instructions to complete the registration. Once you have registered, you will be automatically logged in and enter the process of connecting to the ErgoSportive™.

STEP 3 SIGN IN

In order to identify yourself during subsequent logins, simply enter your email and the password created during your registration, and click on **"Sign in"**.

STEP 4 CONNECT SMART BED

Connect Smart Bed

Open the ErgoSportive APP, select the **"Settings"** tab, click **"Bed Settings"** to enter the smart bed settings page, then click the **"Connect a new bed"** button.

Start Connection

Scan the QR code of the bed or click on the **"Search beds"** button to select your bed and connect it.

Finish Connection

Enter the connection phase and when the progress is 100%, the connection is complete.

Select Data Switch

Select the on/off data switch and you can turn the data storage switch on or off as required.

Select The Bed Side (Double Bed)

Choose the side of the bed you sleep, e.g. Facing the bed, choose to sleep on the left, on the right, or with one person in a double bed.

Calibrate your ErgoSportive™

In order to obtain accurate data, your gender, date of birth, height, weight and mattress thickness are required to complete the calibration. Note, it may take up to seven days for your ErgoSportive™ to fully calibrate, during which time sleep metrics will continue to improve.

Authorize The Garmin® Account

Authorize your Garmin® account in order to access Garmin® data, you can choose to skip this step first.


MORE DETAILS

Please Scan QR code to see more function information and operation.



NOTE

Sleeping position may affect data collection. To ensure the most accurate data, it is recommended to sleep in the center of the bed in single beds or on your selected side in double beds (center if sleeping alone). Sleeping too close to the edge or other unconventional sleeping position will affect the accuracy of date.

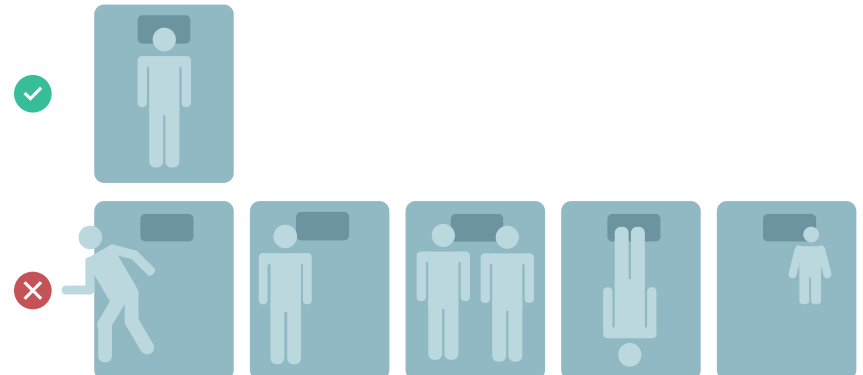

Troubleshooting

If one or more functions on the bed base have stopped operating:

- Check under the bed base to verify that the wired connections are secure and that there are no cords or bedding obstructing the movement of the base.
- Check to ensure the green LED light is illuminated on the control box. If there is no light, verify that the input and power cords are properly connected.
- Unplug the base for 1 minute to reset the electronic components.
- Plug bed base into a different electrical outlet, or test current outlet with another working appliance (a grounded, electrical surge protector is recommended).
- Remove and replace full batteries in the remote control and re-pair the remote to the base (see page 11).

If issue is not resolved by following the instructions above, locate serial number on warranty card or back of remote and contact

ErgoSportive Customer Service: support@ErgoSportive.com

Consignes de sécurité et d'utilisation

Attention : Remarques importantes relatives à la sécurité

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre lit ajustable. Conservez ces instructions.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURE, D'INCENDIE OU DE BLESSURE

Pour optimiser la sécurité et l'efficacité, branchez la base ajustable sur un parasurtenseur (non fourni). La base ajustable ne doit être branchée qu'à une prise murale ou à un parasurtenseur (fortement recommandé). Débranchez toujours la base ajustable de la prise électrique avant de procéder à l'entretien de toute pièce qu'elle comporte. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez la base ajustable avant de la nettoyer. Pour la déconnecter en toute sécurité, assurez-vous qu'elle est à plat avec tous les moteurs éteints et débranchez-la de la source d'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. Ne jamais faire fonctionner la base lorsque les ouvertures d'air sont obstruées. Maintenir les ouvertures d'air libres de poussière, cheveux et autres. Ne laissez pas tomber ou n'insérez aucun objet dans les ouvertures. Cessez d'utiliser la base ajustable et contactez un centre de dépannage qualifié si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'ils ne fonctionnent pas correctement ou s'ils ont été immergés dans de l'eau. N'utilisez cette base ajustable que dans le cadre de l'utilisation prévue décrite dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. Une surveillance constante est requise lorsque le lit ajustable est utilisé par ou près d'enfants, de convalescents, de personnes handicapées ou d'animaux domestiques. Une mauvaise connexion de l'équipement peut entraîner un risque de décharge électrique, d'incendie électrique ou un mauvais fonctionnement de ce lit. Si la fiche n'est pas adaptée à votre prise, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adaptée. Toute modification non autorisée ou le fait de ne pas utiliser une prise murale ou un parasurtenseur peut annuler la garantie en ce qui concerne la partie électrique.

ENFANTS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE

Jetez immédiatement tous les matériaux d'emballage, car ils peuvent

entraîner un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge et les animaux domestiques. Pour éviter les blessures, il est déconseillé aux enfants et aux petits animaux de compagnie de jouer sur ou sous le lit. Les enfants ne doivent pas utiliser la base ajustable sans la surveillance d'un adulte.

STIMULATEURS CARDIAQUES

Certains produits contiennent des AIMANTS en néodyme qui peuvent interférer avec des appareils tels que les stimulateurs cardiaques, les DAI et tout autre appareil sensible aux champs magnétiques. Il est **FORTEMENT** recommandé aux utilisateurs de ces dispositifs médicaux de consulter leur médecin avant d'utiliser des produits qui contiennent des AIMANTS en néodyme. Il est également possible que certains stimulateurs cardiaques interprètent à tort les vibrations de la fonction de massage facultative comme un mouvement ou un exercice. Il s'agit d'une situation fréquente avec tout produit qui crée un mouvement vibrant et qui peut affecter un stimulateur cardiaque. Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser la fonction de massage.

UTILISATION À DOMICILE ET NORMES HOSPITALIÈRES

Les bases ajustables Ergo sont conçues uniquement pour une utilisation à domicile. Ce lit ajustable n'a pas été conçu comme un lit d'hôpital et n'est pas destiné à répondre aux normes hospitalières. N'utilisez pas ce lit avec un équipement d'oxygénothérapie de TYPE TENTE ou à proximité de gaz explosifs.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Les roulettes (en option) sont équipées de roues verrouillables pour éviter tout mouvement indésirable. Même lorsque verrouillées, il est possible que les roulettes glissent. Les moteurs de la tête et du pied utilisent la gravité afin de ramener le lit à plat, plutôt qu'une force exercée vers le bas, minimisant ainsi les points de pincement.

Consignes de sécurité et d'utilisation

Fonctionnement manuel – Si quelque chose se coince dans la plateforme lorsqu'elle est à plat, il est possible de la relever manuellement en la soulevant au niveau de la tête ou du pied pour relâcher la pression et la décoincer.

Arrêt d'urgence – Interrompt les mouvements de la plateforme en appuyant sur n'importe quel bouton de la télécommande.

Coupage de courant – Utilisez la sangle pour piles de secours comme source d'alimentation temporaire pour amener le lit ajustable à la position souhaitée. Les instructions d'utilisation de la sangle pour piles de secours se trouvent sur la page décrivant cet accessoire.

MÉCANISMES DE LEVAGE/ABAISSMENT

La fonction de levage/abaissement émet un bourdonnement minimal pendant le fonctionnement. Ce bruit est normal. Pendant le fonctionnement, les roulettes du bras de levage entrent en contact avec le support de la plateforme de la base ajustable. Ce contact peut entraîner un contact métal sur métal ou métal sur plastique. Ceci applique une légère tension sur les composants mobiles et la résonance est réduite à un niveau minimum. En cas de bruit ou de vibrations excessifs, inversez le mouvement (vers le haut ou vers le bas) de la base à l'aide de la télécommande. Cela devrait réaligner les mécanismes d'activation du lit ajustable sur la position opérationnelle appropriée. En fonctionnement normal, les roulettes, qui permettent au lit de maintenir sa distance par rapport au mur, entrent en contact avec les supports de plateforme en acier de la base ajustable et produisent alors un bruit. Lorsque vous entrez dans le lit, en sortez ou bougez dessus, ce bruit peut être audible lorsque les roulettes entrent en contact. Ce bruit est normal.

MATÉRIAUX

Les lits ajustables Ergo sont fabriqués à partir de divers matériaux, dont différentes essences de bois, des métaux, des plastiques et des tissus. La tension, la pression ou le mouvement appliqué sur le châssis, la plateforme ou le cadre lors d'une utilisation normale peuvent générer un son audible.

FONCTION DE MASSAGE ET EMPLACEMENT DU LIT

La fonction de massage émet un bruit pendant son fonctionnement. Ce bruit est normal. La tonalité s'intensifie au fur et à mesure que le niveau d'intensité du massage augmente. Le volume de ce bruit est directement lié à l'environnement où se trouve le lit. Par exemple, lorsqu'une démonstration du fonctionnement du lit s'effectue dans un magasin, le bruit environnant couvre une partie des sons produits par le massage. Cependant, si le lit est installé dans une maison avec du parquet, avec de la moquette ou non, le volume du massage sera plus perceptible. Pour réduire cette résonance, placez un morceau de tapis, ou des patins en caoutchouc, sous chaque pied ou roulette de la base ajustable. Il est possible de ressentir des vibrations ou du bruit provenant du cadre extérieur de la base ajustable, des supports de la tête de lit, de la tête de lit ou du pied de lit si les boulons de montage ne sont pas fermement serrés. Les niveaux 1 à 3 d'intensité de massage représentent le nombre de tours du moteur par minute. Le niveau 3 indique le nombre maximum de tours par minute. Cependant, cela ne signifie pas que la sensation de vibration sera la plus forte. La sensation de vibrations sera différente en fonction du matériau du matelas, de l'épaisseur et du positionnement de l'utilisateur. Nous recommandons à l'utilisateur de déterminer le réglage d'intensité de massage qui lui convient le mieux. Il est important de comprendre la physique des vibrations. Tout comme un moteur peut tourner irrégulièrement au ralenti, les vibrations changent dès que le régime augmente.

L'ODEUR DE « NOUVEAU PRODUIT »


Certaines personnes remarquent une légère odeur se dégageant de leur nouvelle base ajustable, ce qui peut provenir de notre processus de fabrication et des matériaux employés. Cette odeur est normale et disparaît généralement avant que le produit ne vous soit livré. Parfois, cependant, cette odeur peut encore être perceptible. Elle disparaît généralement après quelques semaines, sous réserve qu'il y ait une ventilation adéquate du produit et de l'environnement.

Consignes de sécurité et d'utilisation

TOLÉRANCE

Toutes les bases ajustables Ergo, en fonction de la marque et du modèle, sont conçues et fabriquées pour fonctionner dans les limites des paramètres de contrôle qualité désignés. Les bases font l'objet d'inspections méticuleuses et rigoureuses au cours du processus de contrôle de la qualité afin de s'assurer qu'elles fonctionneront dans le respect de ces normes pendant une utilisation normale. Une utilisation normale est définie comme suit : Le lit ajustable doit être utilisé avec un matelas et une charge. Les procédures de test font appel à des tests de cycle de vie avec une charge distribuée atteignant 120 kg (264 lb).

L'angle (désigné par un « α » dans l'image) entre la section arrière et la section plate pour les différentes configurations de la plateforme de support du matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui se traduit par une tolérance de 1,5 po (3,7 cm) maximum. L'angle (désigné par un « β » dans l'image) entre la section plate et la section du pied de lit pour différentes configurations de la plateforme de support du matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui se traduit par une tolérance atteignant $\frac{3}{4}$ po (1,9 cm.) Toute base ajustable jugée conforme à ces limites de tolérance est considérée comme ayant satisfait aux normes de contrôle qualité du fabricant.

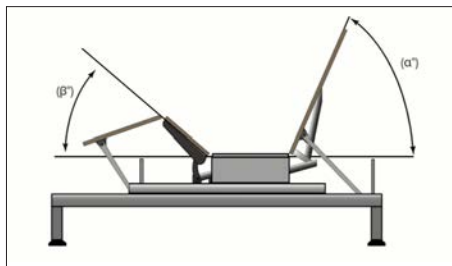

PÉRIODE DE RODAGE

Vous pouvez accélérer la période de rodage en passant simplement du temps dans le lit ajustable en lisant, en regardant la télévision ou en jouant avec vos enfants ou petits-enfants. Ces mouvements supplémentaires aideront la base ajustable à répondre aux changements de poids et de température. Certains des matériaux de nos lits ajustables, tels que les essences de bois, les métaux et les plastiques utilisés dans la plateforme, le cadre et les composantes, sont sensibles à l'humidité et à la température et peuvent produire des sons dans des environnements plus froids.

FONCTIONNEMENT COUPLÉ

Lors de l'utilisation de lits ajustables synchronisés, il peut y avoir un intervalle allant jusqu'à 1,5 secondes entre les mouvements de chaque lit.

USURE

L'usure correspond au dommage qui se produit naturellement et inévitablement à la suite d'une utilisation normale ou du vieillissement du lit ajustable.

ENTRETIEN DU TISSU

Protégez le tissu de la lumière directe du soleil chaque fois que c'est possible afin d'en prolonger la durée de vie. Pour le nettoyage des taches, essuyez la zone avec une éponge légèrement humide ou passez un aspirateur avec une brosse douce pour éliminer les particules. Maintenez les parties en tissu au moins à 12 pouces (30 cm) de sources de chaleur directes. Pour un nettoyage plus en profondeur, épongez les liquides avec un chiffon propre et sec. Essuyez avec un chiffon propre imbibé d'eau tiède. Ne pas mouiller excessivement. Une brosse à poils doux peut être utilisée pour enlever la saleté incrustée. Évitez de rayer la surface en brossant délicatement. Essuyez avec un chiffon propre humidifié avec de l'eau tiède pour éliminer les résidus. Séchez à l'ombre loin d'une source directe de chaleur. Consultez un professionnel si des marques persistantes restent visibles après le nettoyage.

CLASSIFICATION DU PRODUIT

Les moteurs de levage ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de [2] minutes sur une période de [18] minutes ou environ 10 % du cycle de fonctionnement. Tenter de contourner ou dépasser cette valeur peut réduire la durée de vie du produit et annuler la garantie. Les moteurs de relaxation ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de 30 minutes à la fois. Veuillez laisser le système de relaxation inactif pendant 30 minutes après son arrêt automatique avant de le redémarrer.

Consignes de sécurité et d'utilisation

IMPORTANT : CE QU'IL FAUT FAIRE ET CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

CE QU'IL FAUT FAIRE

- Brancher votre base ajustable à un parasurtenseur.
- Répartir uniformément le poids lorsque vous dormez dans une disposition partagée. Une répartition inégale du poids peut entraîner un soulèvement irrégulier de la base.
- Appeler le service à la clientèle pour tout problème technique. N'essayez pas de forcer le mouvement de la base vers le bas, cela pourrait endommager les moteurs ou le cadre.
- Utiliser un savon doux et de l'eau pour nettoyer votre base ajustable si des taches apparaissent.
- Garder à l'esprit qu'il est recommandé d'utiliser les bases ajustables avec des matelas adaptés aux réglages.
- Ramener la base en position horizontale (à plat) après utilisation et entre les pré-réglages.
- Enregistrer votre garantie dès que votre base ajustable a été livrée.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- S'asseoir sur les coins/bords de la base, cela pourrait déformer le cadre, les supports ou la mousse.
- Incliner la base sur le côté. Cela peut endommager les pattes et/ou les vis des pattes.
- Se tenir debout ou sauter sur la base ajustable à tout moment, cela peut endommager le cadre et les moteurs.
- Faire glisser la base pour la déplacer. Cela risquerait d'endommager le cadre, de casser les écrous et les boulons ou de briser les pattes. Achetez des roulettes si vous prévoyez de déplacer votre base régulièrement.
- Entrer et sortir de la base ajustable avec la tête et/ou le pied en position articulée. Vous devez toujours entrer ou sortir de votre base ajustable en position à plat (horizontale).
- Bricoler ou modifier la base. Cela annulera la garantie.
- Appuyer sur la tête ou le pied pendant la manœuvre peut endommager le cadre et les moteurs.
- Ne pas utiliser de matelas contenant plus de 5 cm de latex.

LIMITES DE POIDS

Ce produit n'est pas conçu pour supporter des poids de plus de 750 lb (340 kg). Ces limites comprennent le poids du matelas et de la literie. Le lit ajustable soutiendra structurellement ce poids, à condition qu'il soit uniformément réparti sur toute sa surface. Le lit ajustable n'est pas conçu pour supporter ou soulever de tels poids au niveau de la tête ou du pied de lit. Le dépassement de cette limite de poids annulerait la garantie, pourrait endommager le lit et/ou causer des blessures.

CONFORMITÉ FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déterminé comme se conformant aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un contexte particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise relevant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Liste des pièces

Avant de jeter les matériaux d'emballage, assurez-vous que toutes les pièces sont bien présentes.

Toutes les composantes électroniques et les éléments qui doivent être installés sont placés dans des boîtes sous le lit ajustable ou fixés au cadre.



- A) Télécommande sans fil et piles AAA (3)
- B) Pattes x6
- C) Barre de soutien du matelas* x2
- D) Cordon d'alimentation
- E) Bloc d'alimentation
- F) Sangle pour piles de secours (2) Piles 9 V (non incluses)
- G) Cordon de synchronisation‡
- H) Sangle de raccordement‡*
- I) Pinces en C x2
- J) Boulons longs (4), rondelles (8), écrous (4)
- K) Clé hexagonale externe de 13 mm (1), Clé hexagonale de 5 mm (1)

Pièces recommandées (non incluses) :



- L) Parasurtenseur
- M) Piles alcalines de 9 volts x2

*Ces éléments sont fixés à la base pour des raisons d'expédition. Retirez-les délicatement de la base et mettez-les de côté.

‡ Uniquement inclus pour les lits ajustables Simple XL et Split King.

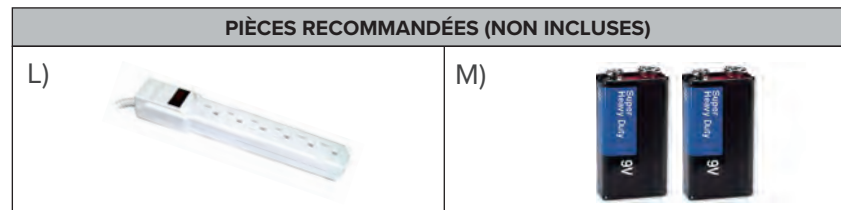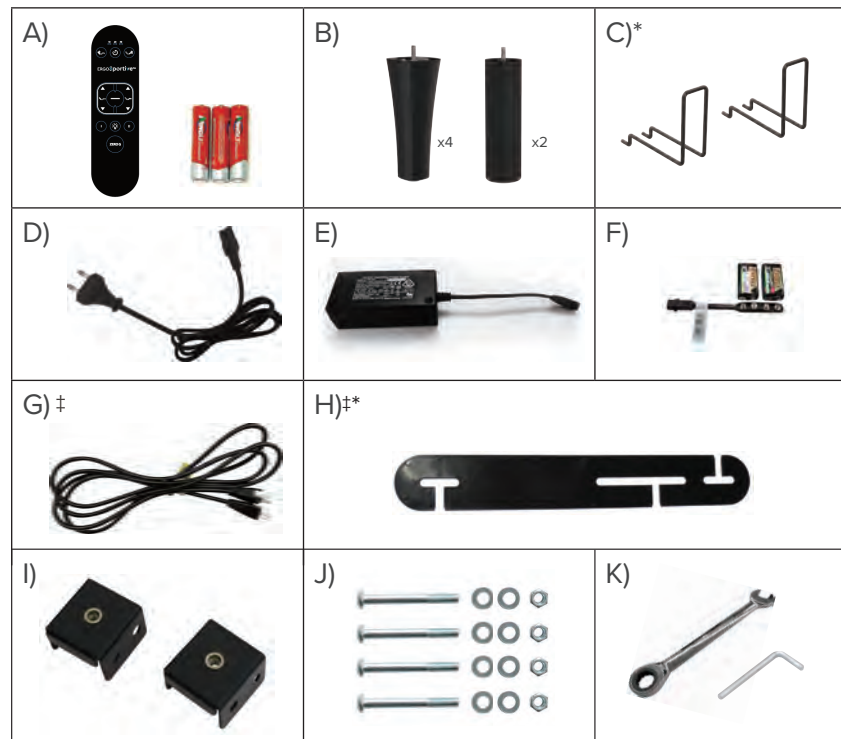

Vue d'ensemble : lit et télécommande

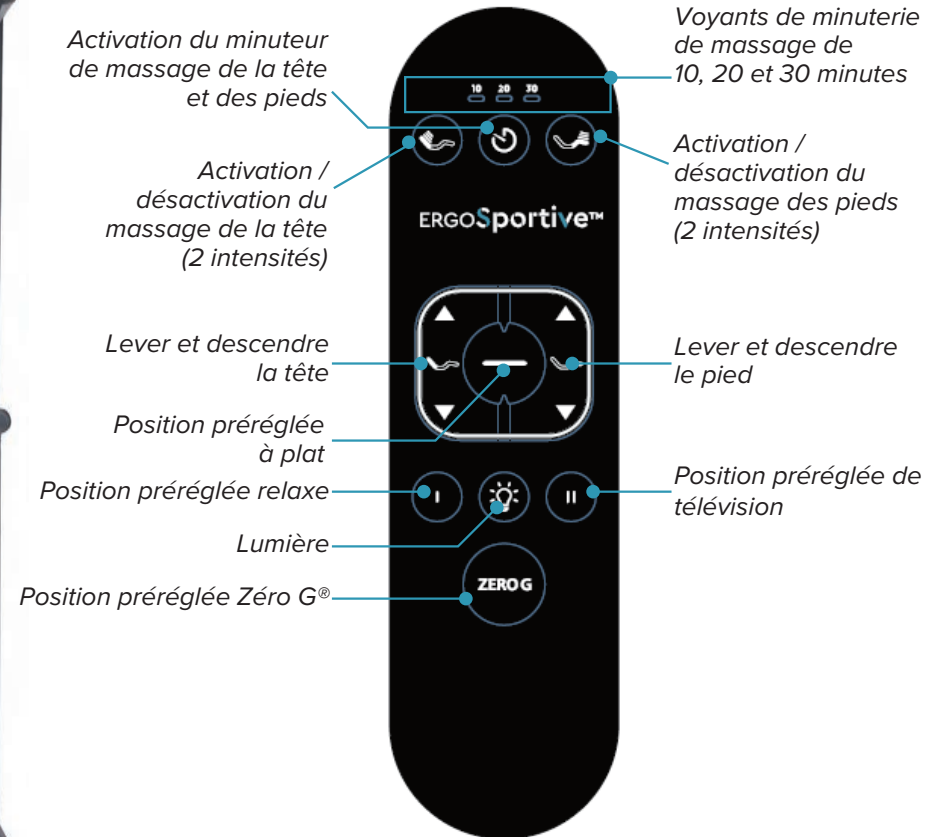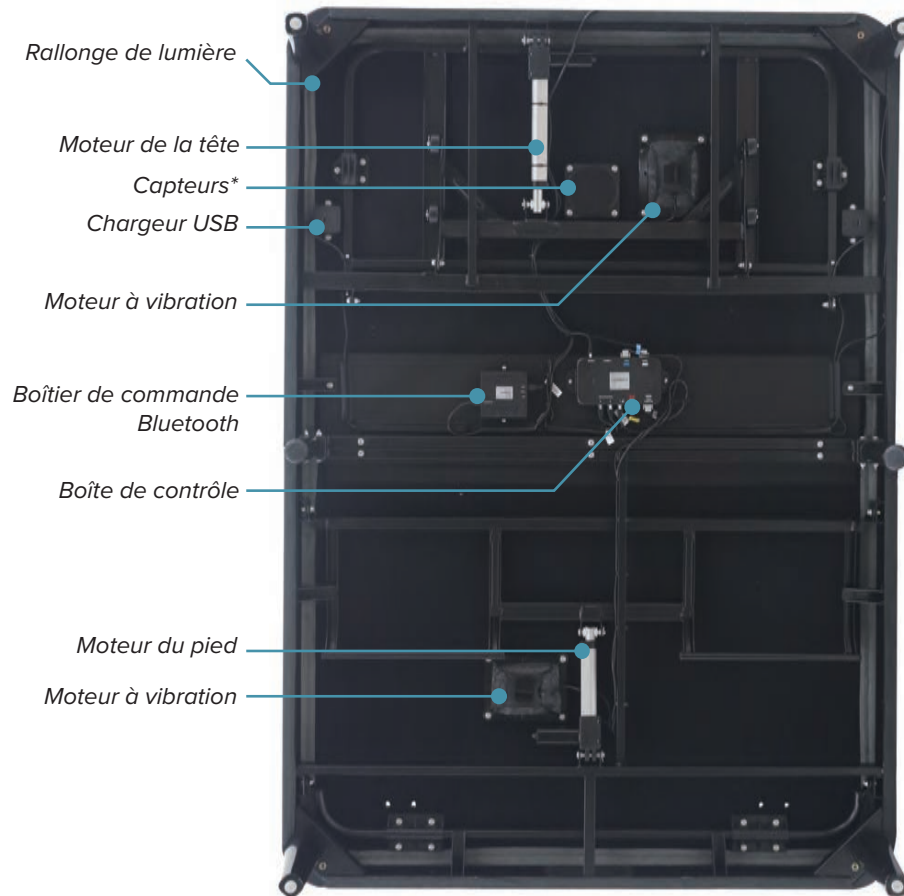


* Note : Les lits Queen ont deux capteurs.

Guide de référence rapide

Pas à l'échelle. À titre d'illustration seulement. Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.

APERÇU DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

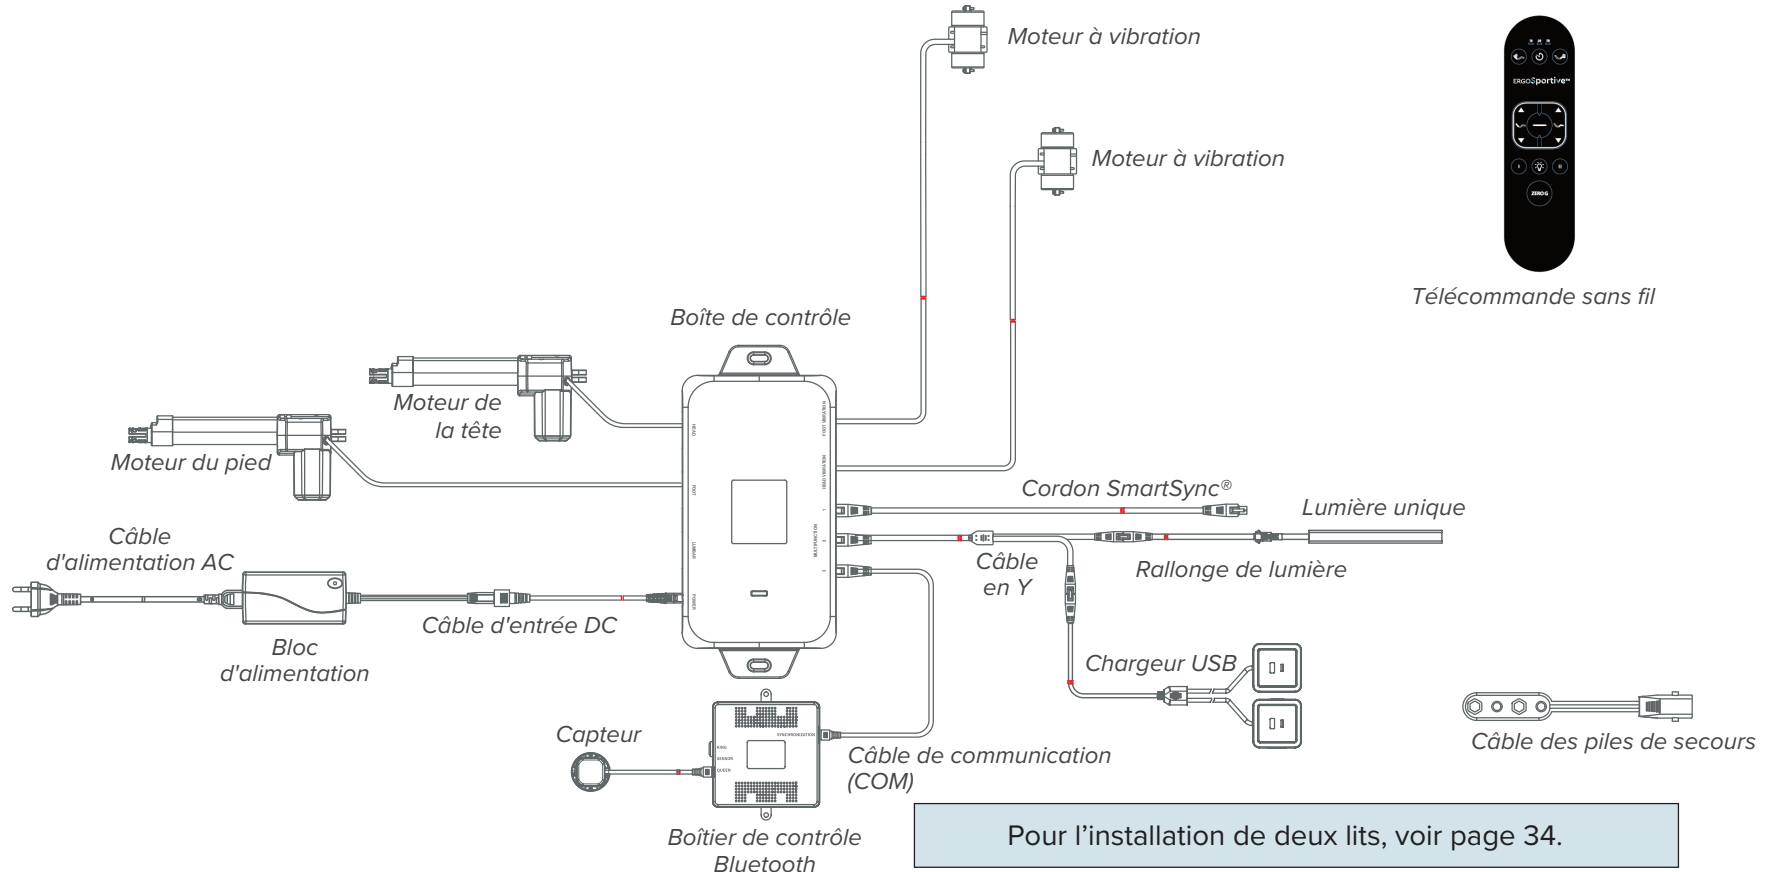


Guide d'installation

Le lit doit toujours être déplacé, ou retourné par deux personnes.

ÉTAPE 1

Retirez la base de la boîte en gardant le dessous de la base vers le haut.

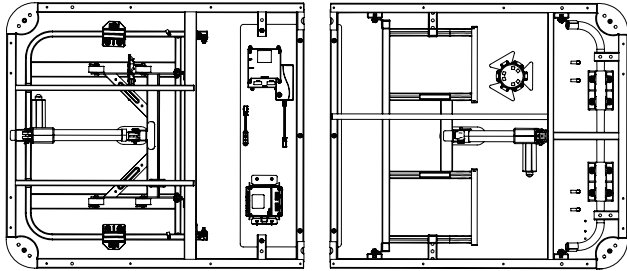

ÉTAPE 2

Joignez les deux sections de la base ensemble, faites glisser la pince en C sur les connexions du cadre (voir la figure B) au milieu des deux côtés de la base.

Fig A





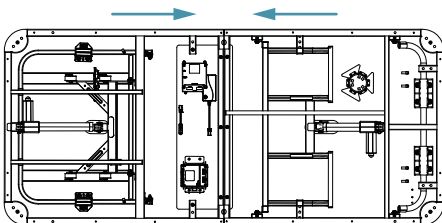


Fig B

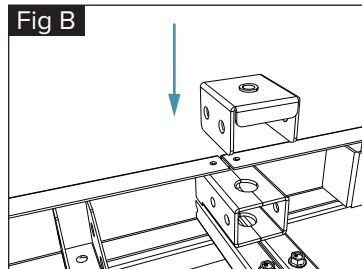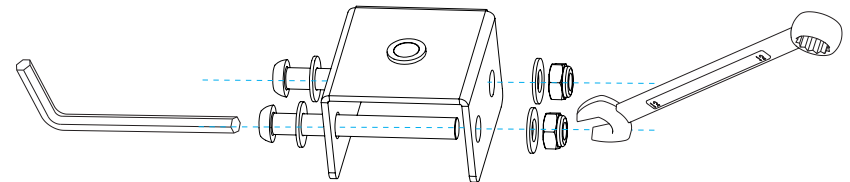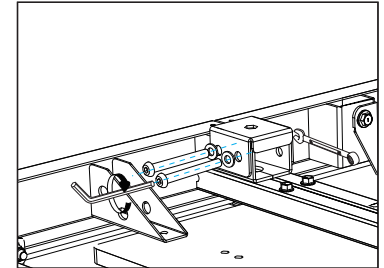

ÉTAPE 3

Insérez deux boulons longs à travers une rondelle avant de les introduire dans les trous situés sur le côté de la pince en C. Utilisez les clés hexagonales.

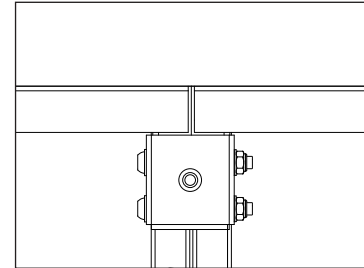

ÉTAPE 4 (Optionel)

Pour installer les pattes, placez une rondelle sur la partie fileté de chaque patte, la partie arrondie vers la patte. Insérez chacune des quatre pattes coniques aux coins du lit en utilisant les trous de boulon les plus proches du bord long du lit. Installez les deux pattes cylindriques (rondes) au centre des pinces en C préalablement installées à la jonction des deux sections. Vissez les pattes à la main.

Ne pas trop serrer.

Remarque : Si vous installez le lit ErgoSportive sur une plateforme ou un cadre de lit avec des lattes, il n'est pas nécessaire d'installer les pattes.

Guide d'installation

ÉTAPE 5

Pour synchroniser deux bases, voir les instructions d'installation détaillées à la page 34.

Repérez la sangle pour piles de secours et mettez-la de côté. Assurez-vous qu'elle soit bien accessible après l'installation de la base.

ÉTAPE 6

Déroulez le câble d'alimentation d'entrée (connecté au port d'alimentation de la boîte de contrôle) et branchez-le au bloc d'alimentation.



ÉTAPE 7

Déroulez le câble d'alimentation et connectez-le au bloc d'alimentation. Placez le bloc d'alimentation sur le sol et faites-le sortir de la base. Assurez-vous que le bloc d'alimentation et tous les câbles qui y sont reliés sont dirigés vers le parasurtenseur souhaité.



ÉTAPE 8

Retournez délicatement la base.

Important : Deux personnes sont nécessaires pour déplacer la base de lit. Ne pas la traîner sur le sol. Ne pas faire reposer la base sur le côté, une pression excessive pourrait endommager les pattes (si utilisées).

ÉTAPE 9

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique. **Un parasurtenseur est recommandé.**

ÉTAPE 10

La télécommande doit être utilisée dans les 10 secondes qui suivent la mise sous tension du lit pour garantir la réussite de la synchronisation. Testez rapidement les fonctions de la télécommande pour vérifier la bonne configuration avant de placer le matelas sur la base. Remettez la base en position à plat avant de placer le matelas dessus.

ÉTAPE 11


Installez les barres de soutien du matelas en insérant les deux extrémités de la barre dans les trous de la base pour ensuite les abaisser vers la base les barres tout en maintenant le côté incurvé vers le haut.



La configuration est maintenant terminée ! Testez toutes les fonctions de la télécommande.

Télécommande

La télécommande arrive synchronisée à la base réglable.
Trois (3) piles AAA sont nécessaires pour faire fonctionner la télécommande.

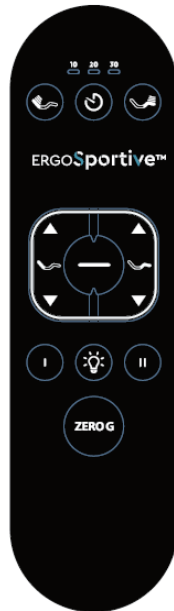





POUR PROGRAMMER LES POSITIONS PRÉRÉGLÉES :

Articulez la tête et le pied jusqu'à la position souhaitée. Ensuite, appuyez sur l'un des boutons de pré-réglage [I, II] et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La position est maintenant enregistrée.

NOTE : Pour restaurer les boutons de pré-réglage à leurs configurations d'usine, maintenez simultanément enfoncés les boutons FLAT et ZERO G pendant au moins 5 secondes. Les pré-réglages d'origine seront restaurés.






FONCTIONS DE MASSAGE

-  Le bouton TÊTE permet d'activer le massage de la tête. Vous pouvez choisir entre 2 intensités de massage.
-  Le bouton PIED permet d'activer le massage des pieds. Vous pouvez choisir parmi 2 intensités de massage.
-  Minuterie de massage. Réglez la durée du massage sur 10, 20 ou 30 minutes.
- 10**  Le voyant situé dans le haut de la télécommande indique le réglage d'une minuterie de 10, 20 ou 30 minutes. Le massage s'arrête automatiquement après 10 minutes si la minuterie de massage n'est pas réglée.

AJUSTEMENTS

-  Les flèches TÊTE ▲ ▼ permettent de soulever et d'abaisser la section de la tête de la base.
-  Les flèches PIED ▲ ▼ permettent de soulever et d'abaisser la section des pieds de la base.

BOUTONS TOUCHE UNIQUE

- ZERO G**  Position pré-réglée à touche unique Zero G®. La fonction Zéro G® ajuste vos jambes à un niveau plus élevé que votre cœur; ce qui aide à améliorer la circulation.
-  Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour ajuster la luminosité.
-  Position pré-réglée à touche unique À PLAT.
- I**  Position pré-réglée à touche unique RELAXE.
- II**  Position pré-réglée à touche unique TV.


Synchronisation de la télécommande

Synchronisation de la télécommande

La télécommande d'origine qui se trouve dans la boîte est déjà synchronisée au lit ajustable. Aucune autre action n'est requise. Dans le cas où la télécommande n'est pas synchronisée au lit, suivez les étapes ci-dessous.

ÉTAPE 1

Débranchez le câble d'alimentation de votre prise électrique. Attendez 1 minute, puis rebranchez-le dans votre prise. Effectuez l'étape 2 dans les 10 secondes, pendant que le voyant de la boîte de contrôle est allumé.

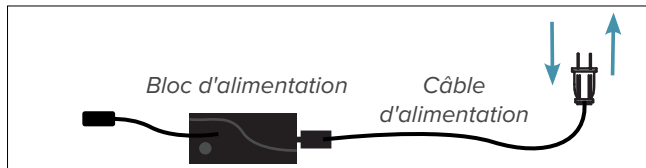

ÉTAPE 2

Appuyez et maintenez le bouton de SYNCHRONISATION à l'arrière de la télécommande. Le bouton de SYNCHRONISATION s'allumera et commencera à clignoter. Lorsque le bouton de SYNCHRONISATION cesse de clignoter, le voyant lumineux sur la boîte de contrôle s'éteindra. Relâchez ensuite le bouton de SYNCHRONISATION.



ÉTAPE 3

La télécommande est maintenant synchronisée à la base ajustable. Testez toutes les fonctions de la télécommande. Si les boutons de la télécommande n'ont aucun impact sur les mouvements de la base ajustable, veuillez recommencer le processus.

Sangle pour les piles d'urgence

Pour utilisation d'urgence uniquement, en cas de panne de courant.

Les piles ne doivent pas être utilisées pour le fonctionnement normal du lit.

ÉTAPE 1

Débranchez le dispositif d'alimentation du câble d'alimentation d'entrée.


ÉTAPE 2

Connectez la sangle pour piles de secours aux (2) piles alcalines de 9 volts. Ne mélangez pas des marques différentes.



ÉTAPE 3

Connectez l'extrémité de la sangle pour piles de secours au cordon d'entrée qui est fixé à la boîte de contrôle.

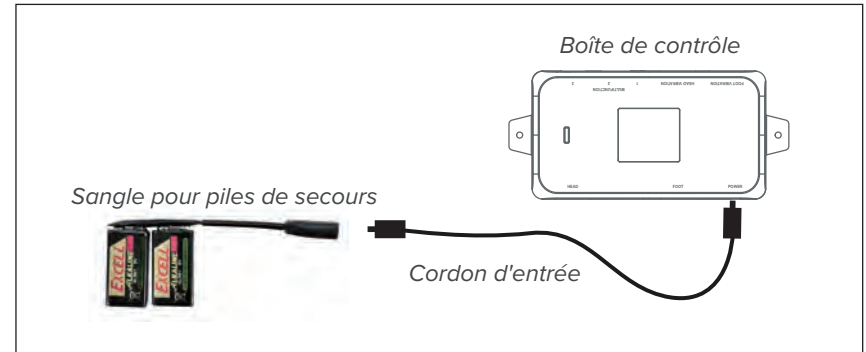

ÉTAPE 4

Utilisez ensuite la télécommande pour remettre le lit à plat.

Remarque : Détachez la sangle pour piles de secours et rebranchez l'alimentation une fois la situation d'urgence terminée, car le système continuera d'utiliser les piles même s'il n'est pas en fonctionnement.

Synchronisation de deux bases (facultatif)

Un cordon SmartSync® est inclus avec la base. Uniquement disponible sur certains modèles. Le cordon SmartSync® relie deux différentes boîtes de contrôle à une seule télécommande afin de synchroniser deux bases. Veuillez connecter le câble de synchronisation avant d'installer la tête de lit.

ÉTAPE 1

Débranchez les bases de la source d'alimentation.

ÉTAPE 2

Connectez le cordon SmartSync® au port multifonction de chaque boîte de contrôle.


ÉTAPE 3

Rebranchez les bases sur la source d'alimentation.

ÉTAPE 4

Assurez-vous que tous les cordons sont bien fixés. Les deux télécommandes vont maintenant fonctionner sur les deux bases simultanément.

Le système est maintenant relié. Les boutons pressés sur l'une ou l'autre des télécommandes permettent de contrôler les deux bases simultanément.

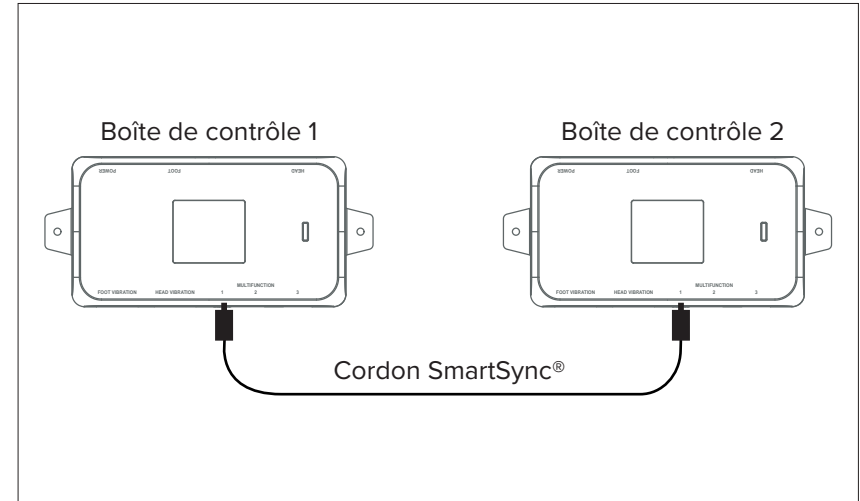

NOTES DE PERFORMANCE

Si les bases sont mal synchronisées, le fait de les remettre en position à plat permet de resynchroniser les positions.

Contrôler la lumière DEL séparément (facultatif)


Cette page a pour but d'expliquer comment permettre aux deux télécommandes de contrôler la bande lumineuse lorsque le cordon de synchronisation est débranché. S'applique uniquement au King séparé.

ÉTAPE 1

Débranchez le câble de synchronisation du lit A et du lit B.

ÉTAPE 2

Appuyez sur le bouton À PLAT des télécommandes A et B et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant des télécommandes clignotent. Les voyants s'arrêtent de clignoter lorsque la synchronisation est terminée.



ÉTAPE 3

Si les lumières des télécommandes clignotent pendant un long moment, cela signifie que la synchronisation a échoué. Attendez 20 s pour que les lumières cessent de clignoter. Puis répétez l'étape 2.


Sangle de raccordement (facultatif)

Les sangles de raccordement sont fixées au cadre de la base dès la livraison. Les pattes sont nécessaires pour l'installation des sangles de raccordement.

ÉTAPE 1

*Les pattes sont nécessaires pour l'installation des équerres de tête de lit. Pour acheter des pattes, veuillez contacter le **service clientèle**: support@ergosportive.com*

Une fois les bases positionnées à l'endroit souhaité, dévissez légèrement les deux pattes qui seront attachées ensemble afin de permettre l'installation de la sangle sur la partie fileté de la patte, entre la rondelle et le lit.

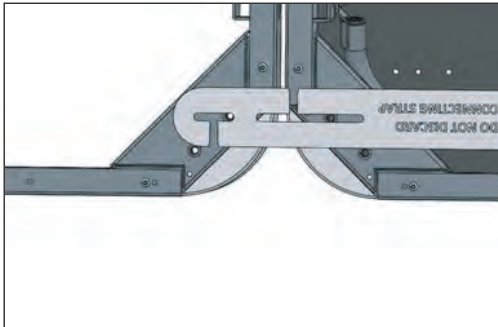

ÉTAPE 2

Glissez l'extrémité de la sangle (a) sur la partie fileté d'une des pattes. Faites pivoter la sangle et attachez l'extrémité (c) sur la partie fileté de l'autre patte. Fixez la sangle en la déplaçant vers la gauche.








ÉTAPE 3

Resserrez les pattes. Ne pas trop serrer. Utilisez l'autre sangle pour répéter les étapes 1 et 2 à l'autre extrémité de la base.

Guide d'installation de la tête de lit (facultatif)

Liste des pièces :

Toutes les pièces suivantes ne sont pas incluses dans le lit, elles sont emballées avec la tête de lit. En cas de besoin, elles peuvent également être vendues comme accessoire.



A) 	B) 	C) 
Équerre de tête de lit X2	Embout tête de lit X2	Vis hexagonale X6
D) * 	E) 	
Clé hexagonale de 5 mm X1	Équerre de tête de lit X2	

* La clé hexagonale est incluse avec l'ensemble des pièces de fixation pour la tête de lit.

Notez que les pièces B servent aux lits de format Simple XL et Grand lit. Les pièces E sont réservées aux lits de format Très grand lit.

ÉTAPE 1


Utilisez les deux (2) vis hexagonales pour fixer la boucle femelle de l'équerre de tête de lit au cadre du lit.

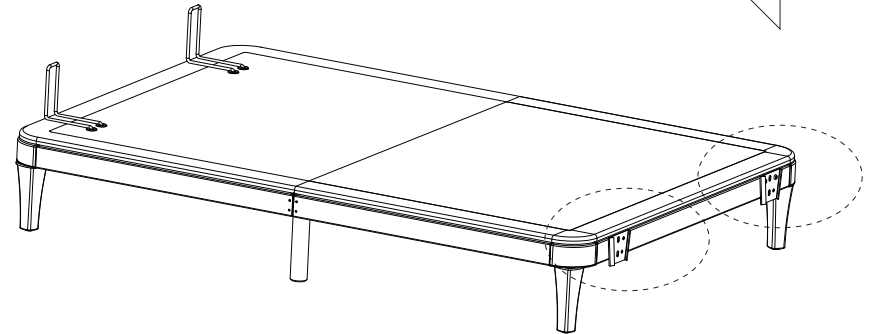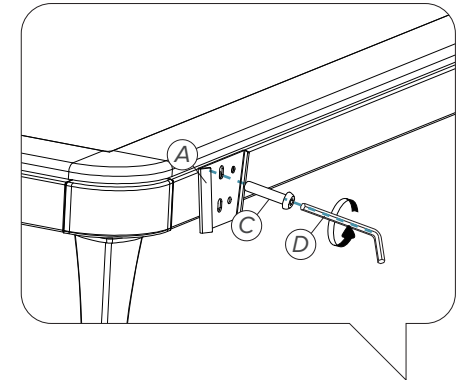


Guide d'installation de la tête de lit (facultatif)

ÉTAPE 2 (Pour les têtes de format Très grand lit seulement)

Retirez les quatre vis hexagonales des embouts de tête de lit préinstallés.

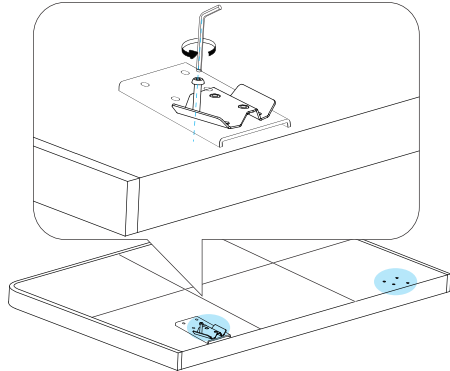


Utilisez les quatre vis préalablement retirées afin de rattachez l'équerre à la tête de lit en utilisant les quatre trous les plus dans le haut. Fixez solidement.

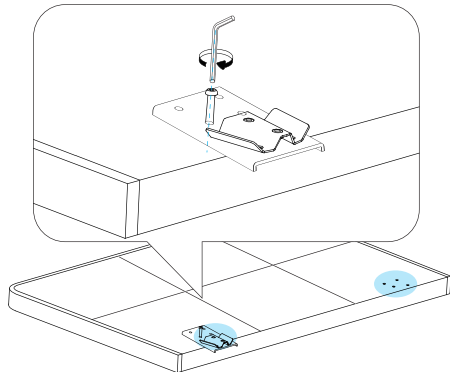

ÉTAPE 3


Deux personnes sont requises pour soulever la tête de lit, aligner la boucle mâle de la tête de lit avec la boucle femelle et insérer la tête de lit verticalement.

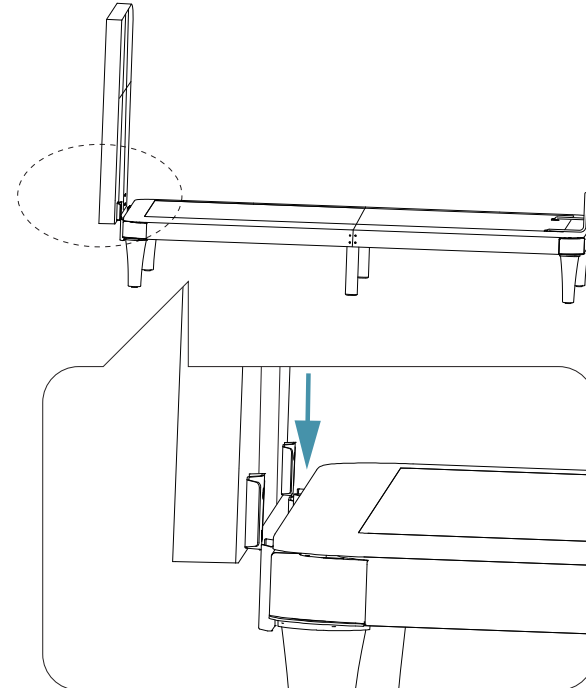

Guide d'installation de la tête de lit (facultatif)


ÉTAPE 4

Activez le lit et levez la tête ajustable. Insérez une vis hexagonale et serrez-la pour fixer fermement la tête de lit à la base. Notez qu'il peut s'avérer nécessaire de soulever légèrement la tête de lit pour aligner la vis.

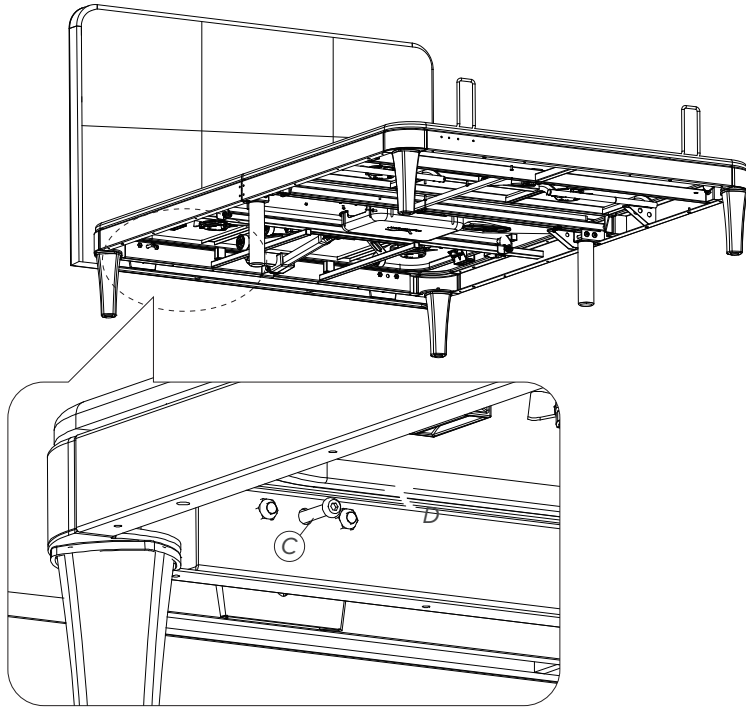

ÉTAPE 5

Débranchez le lit de l'alimentation électrique. Connectez la lampe à DEL. Rebranchez le lit à l'alimentation électrique.

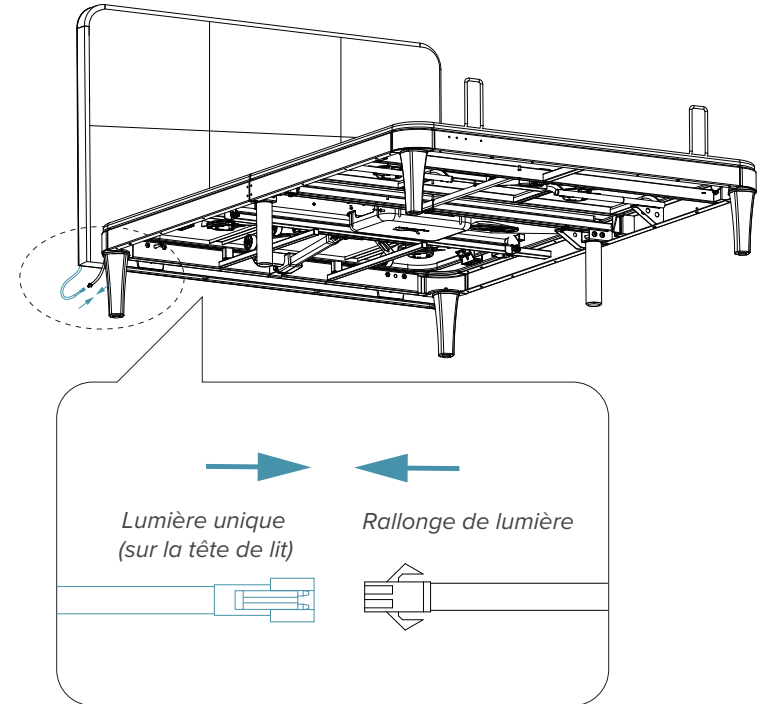

Vidéo d'assemblage



Veillez scanner ce code QR pour voir la vidéo d'assemblage.

Application ErgoSportive™

ÉTAPE 1 TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Télécharger l'application ErgoSportive™ Téléchargez la version Android de l'application depuis le Google Play. Téléchargez la version iOS de l'application à partir de l'Apple Store.



ÉTAPE 2 INSCRIPTION

Ouvrez l'application ErgoSportive™, cliquez sur le bouton « **S'inscrire** » sur la page d'inscription et suivez les instructions pour compléter l'inscription. Une fois que vous vous serez inscrit, vous serez automatiquement connecté et vous pourrez entamer le processus de connexion au ErgoSportive.

ÉTAPE 3 S'IDENTIFIER

Afin de vous identifier lors des connexions suivantes, il vous suffira d'entrer votre courriel et votre mot de passe, créé lors de votre enregistrement, et de cliquer sur « **Se connecter** ».

ÉTAPE 4 CONNECTER LE LIT INTELLIGENT

Connecter le lit intelligent

Ouvrez l'application ErgoSportive, sélectionnez l'onglet « **Réglages** », cliquez sur « **Paramètres du lit** » pour accéder à la page des réglages du lit intelligent, puis appuyez sur le bouton « **Connecter un nouveau lit** ».

Démarrer la connexion

Scannez le code QR du lit ou appuyez sur le bouton « **Recherchez des lits** » pour sélectionner votre lit et le connecter.

Terminer la connexion

Accédez à la phase de connexion et une fois que la progression atteint 100 %, la connexion est terminée.

Commutateur de données

Sélectionnez le commutateur de données et vous pouvez activer ou désactiver le stockage de données en fonction des besoins.

Sélectionner le côté du lit (en cas de lit double)

Sélectionnez le côté du lit sur lequel vous dormez, pas exemple choisissez de dormir à gauche, à droite, ou avec une personne dans un lit double.

Calibrer votre ErgoSportive™

Afin d'obtenir des données précises, votre sexe, votre date de naissance, votre grandeur, votre poids et l'épaisseur de votre matelas sont nécessaires pour compléter le calibrage. Veuillez prendre en compte que le calibrage complet de votre ErgoSportive™ peut prendre jusqu'à sept jours, période pendant laquelle les indicateurs de sommeil seront améliorés en continu.

Autoriser le compte Garmin®

Autorisez votre compte Garmin® afin d'accéder aux données Garmin®. Vous pouvez choisir d'ignorer cette étape.


PLUS DE DÉTAILS

Veuillez scanner le code QR pour obtenir plus d'informations sur les caractéristiques et le fonctionnement de l'appareil.



REMARQUE

La position du sommeil peut affecter la collecte de données. Pour assurer les données les plus précises, il est recommandé de dormir au centre du lit dans le cas d'un lit Simple ou sur votre côté de lit choisi en cas d'un Grand lit (au centre si vous dormez seul(e)). Le fait de dormir trop proche du bord ou dans une position inhabituelle affectera la précision des données.

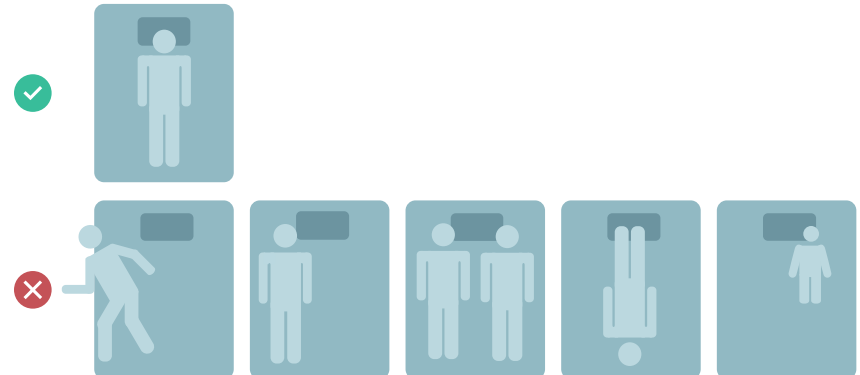

Si une ou plusieurs fonctions de la base de lit ont cessé de fonctionner :

- Vérifiez sous la base de lit que toutes les connexions sont bien fixées et qu'aucun cordon ou pièce de literie n'entrave les mouvements de la base.
- Vérifiez que le voyant vert est allumé sur la boîte de contrôle. S'il n'est pas allumé, vérifiez si l'entrée et les cordons d'alimentation sont correctement connectés.
- Débranchez la base pendant 1 minute afin de réinitialiser les composants électroniques.
- Branchez la base ajustable sur une autre prise électrique ou testez la prise actuelle avec un autre appareil qui fonctionne (il est recommandé d'utiliser un parasurtenseur mis à la terre).
- Retirez et remplacez les piles de la télécommande, puis appariez à nouveau la télécommande sur la base (voir page 32).

Si le problème n'est pas résolu en suivant les instructions ci-dessus, repérez le numéro de série sur la carte de garantie ou au dos de la télécommande et contactez le

Service à la clientèle d'Ergomotion : support@ergosportive.com

Notes

Service à la clientèle : support@ergosportive.com
Site web : ergosportive.com

©2022 Ergomotion Inc.
V002_8/2022 35014951

Numéro de série

+

+

+

+